


Withings Sleep Analyzer

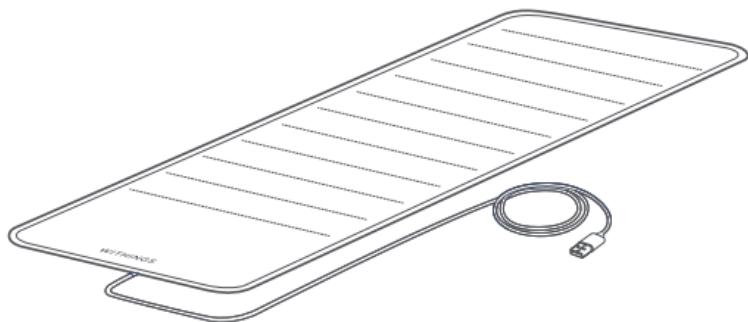

QUICK INSTALLATION GUIDE

PIKA-ASENNUUSOPAS | SNABBINSTALLATIONSGUIDE | HURTIG INSTALLATIONSVEJLEDNING | HURTIGINSTALLASJONSVEILEDNING

EN | FI | SW | DA | NO


THANK YOU FOR CHOOSING WITHINGS SLEEP ANALYZER

KIITOS KUN VALITSIT WITHINGS SLEEP ANALYZERIN |
TACK FÖR ATT DU VÄLJER WITHINGS SLEEP ANALYZER-MODELL |
TAK, FORDI DU VALgte WITHINGS SLEEP ANALYZER |
TAKK FOR AT DU VALGTE WITHINGS SLEEP ANALYZER

This guide is available in additional languages at: www.withings.com/guides

Box contents

Pakkausen sisältö | Förpackningens innehåll | Indhold i boksen | Innhold i esken

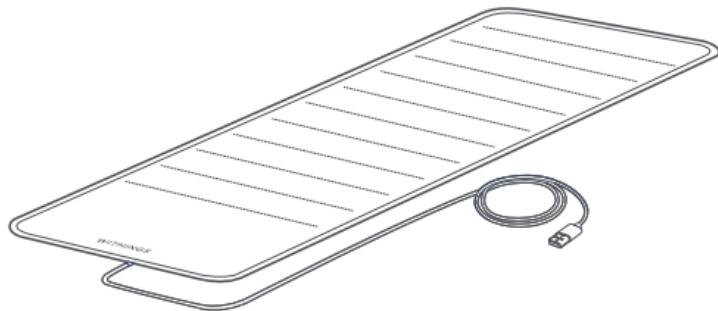

Sleep Sensor

FI Unianturi

SW Sömnsensor

DA Søvnsensor

NO Søvnsensor



USB Power Adapter

FI USB-virta-adapteri

SW USB-nätadapter

DA USB-strømadapter

NO USB-strømadapter

CAUTION

EN - Only the power supply that was included with the device should be used.

Note: power supply pictured may not resemble yours as they can vary by region.

FI - Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua virtalähettää.

Huom: Kuvan virtalähde saattaa poiketa omastasi, sillä virtalähteissä on alueellisia eroja.

SWE -Endast den strömadapter som medföljde enheten får användas.

Observera att strömadaptern på bilden kanske inte liknar din, eftersom de kan variera beroende på region.

NO - Bruk kun strømforsyningen som fulgte med enheten.

Merk: Strømforsyningen på bildet ligner kanskje ikke på din, siden dette kan variere fra sted til sted.

DK -Anvend kun den strømforsyning, som følger med enheden.

Bemærk: Strømforsyningen på billedet ligner muligvis ikke din, da de kan variere fra område til område.

How to install your Withings Sleep Analyzer

Withings Sleep Analyzerin asentaminen | Så här installerar du Withings Sleep Analyzer | Sådan installeres din Withings Sleep Analyzer | Slik installerer du Withings Sleep Analyzer

1


**Place the entire sleep sensor under your mattress,
so that it will be positioned underneath your chest.
Only the cable should extend beyond the edge of
your mattress.**

FI Aseta koko unianturi patjan alle niin, että se asettuu
rintasi kohdalle. Vain latausjohdon tulisi ulottua patjan
reunan yli.

SW Placera hela sovsensorn under madrassen så att den
hamnar under bröstkorgen. Endast kabeln ska sträcka
sig utanför kanten på madrassen.

DA Placer hele søvnsensoren under din madras, så den vil
blive placeret under brystet. Kun kablet må række ud
over kanten af din madras.

NO Plasser hele søvnsensoren under madrassen, slik at den
er plassert under brystet ditt. Kun kabelen skal strekke
seg utover kanten av madrassen.

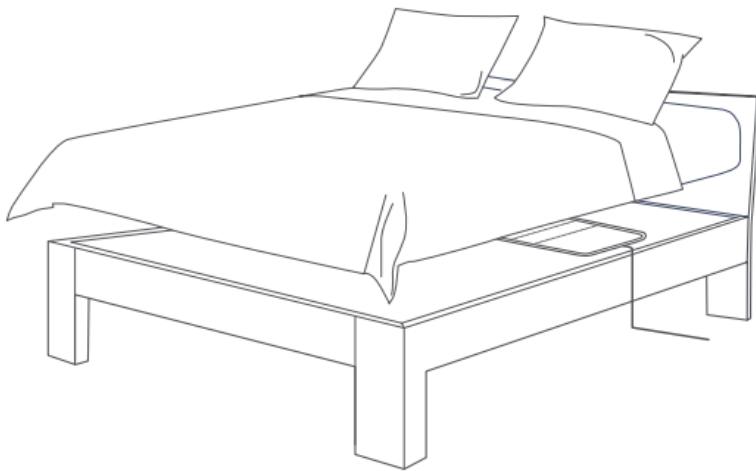

2


Plug the sensor into an outlet using the provided adapter.

FI Liitä anturi pistorasiaan mukana toimitetulla adapterilla.

SW Anslut sensorn till ett eluttag med hjälp av den medföljande adaptern.

DA Sæt sensoren i en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende adapter.

NO Koble sensoren til en stikkontakt ved hjelp av den medfølgende adapteren.

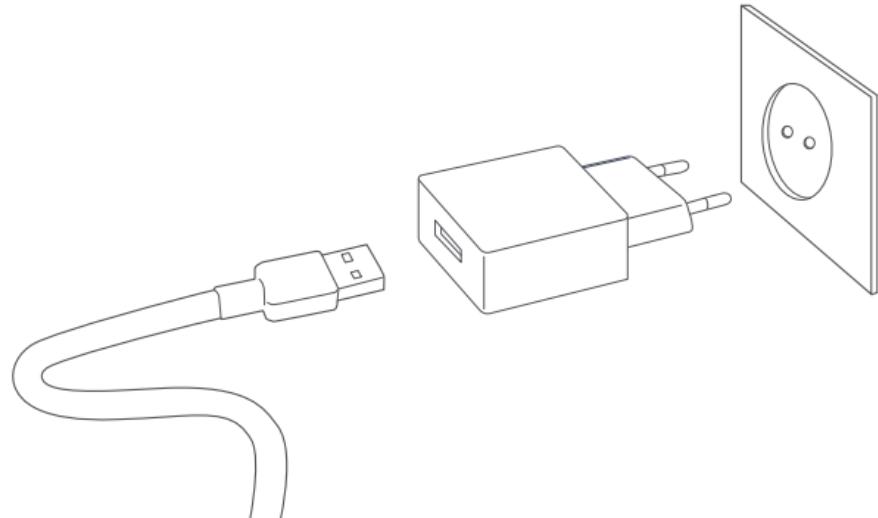

How to install your Withings Sleep Analyzer

Withings Sleep Analyzerin asentaminen | Så här installerar du Withings Sleep Analyzer | Sådan installeres din Withings Sleep Analyzer | Slik installerer du Withings Sleep Analyzer

3

Visit go.withings.com from your smartphone or tablet, and follow the instructions to install the Health Mate app.

FI Käy osoitteessa go.withings.com älypuhelimella tai tabletilla ja asenna Health Mate -sovellus .”

NO Besøk go.withings.com fra smarttelefonen eller nettbrettet, og følg instruksjonene for å installere Health Mate-appen.

SW Besök go.withings.com från din smartphone eller surfplatta och följ instruktionerna för att installera Health Mate-appen.

DA Besøg go.withings.com fra din smartphone eller tablet, og følg instruktionerne for at installere Health Mate-appen.

4

In the Health Mate app, follow the instructions to install Withings Sleep Analyzer.

FI Asenna Withings Sleep Analyzer Health Mate -sovelluksessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

SW I Health Mate-appen följer du instruktionerna för att installera Withings Sleep Analyzer.

DA Følg instruktionerne i Health Mate-appen for at installere Withings Sleep Analyzer.

NO Følg instruksjonene i Health Mate-appen for å installere Withings Sleep Analyzer.




Care and maintenance

Huolto ja ylläpito | Skötsel och underhåll | Pleje og vedligeholdelse | Stell og vedlikehold

To clean the textile cover of the sensor, gently remove the cover first. The cover can be machine washed, but do not tumble dry or iron it. Wait until the cover is completely dry before replacing it on the sensor.



- FI** Puhdista anturin tekstuilikansi irrottamalla se ensin. Kansi voidaan pestää koneessa, mutta sitä ei saa kuivata kuivausruummussa tai silittää. Odota, kunnes kansi on täysin kuiva ennen kuin kiinnität sen takaisin anturiin.
- SW** För att rengöra textilskyddet på sensorn, ska du först försiktigt ta bort skyddet. Skyddet kan tvättas i maskin, men får inte torktumlas eller strykas. Vänta tills skyddet är helt torrt innan du sätter tillbaka det på sensorn.
- DA** For at rengøre sensorens tekstiloevertræk skal du forsigtigt fjerne overtrækket først. Overtrækket kan maskinvaskes, men må ikke tørretumbles eller stryges. Vent til overtrækket er helt tørt, inden det kommes på sensoren igen.
- NO** For å rengjøre tekstiltrekket til sensoren, fjerner du først trekket forsiktig. Trekket kan maskinvaskes, men ikke tørkes i tørketrommel eller strykes. Vent til trekket er helt tørt før du legger det tilbake på sensoren.

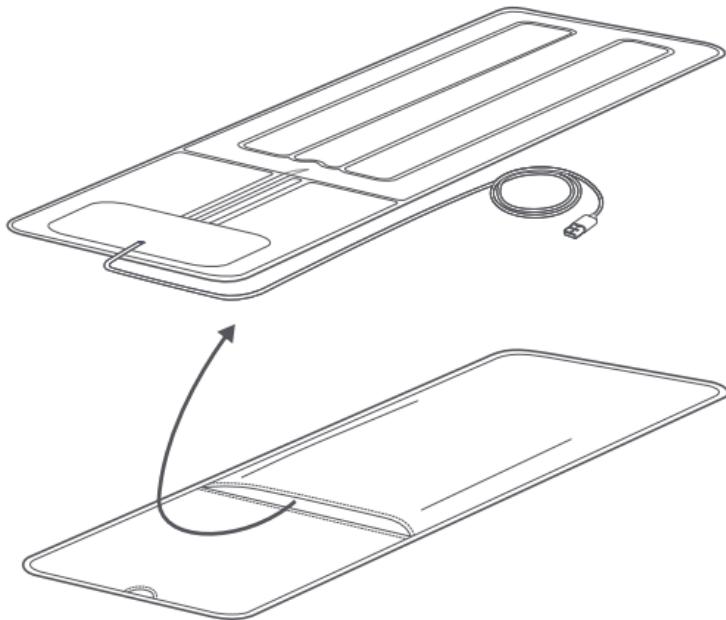

Overview

Yleiskatsaus | Översikt | Oversigt | Oversikt

10 - 11

A Air bladder

FI Ilmakalvo
SW Luftblåsa
DA Lufttblære
NO Lufttblære

D USB power adapter

FI USB-virta-adapteri
SW USB-nätadapter
DA USB-strømadapter
NO USB-strømadapter

B Textile cover

FI Tekstiilikansi
SW Textilskydd
DA Tekstilovertræk
NO Tekstiltrekk

E Sound sensor for snore detection


FI Äänianturi kuorsauksen havaitsemiseen
SW Ljudsensor för snarkdetektering
DA Lydsensor til snoredetektion
NO Lydsensor for snorkedeteksjon

C USB cable

FI USB-johto
SW USB-kabel
DA USB-kabel
NO USB-kabel

F Setup LED

FI LEDin käyttöönotto
SW Opsætnings-LED
DA Installations-LED
NO Installasjons-LED

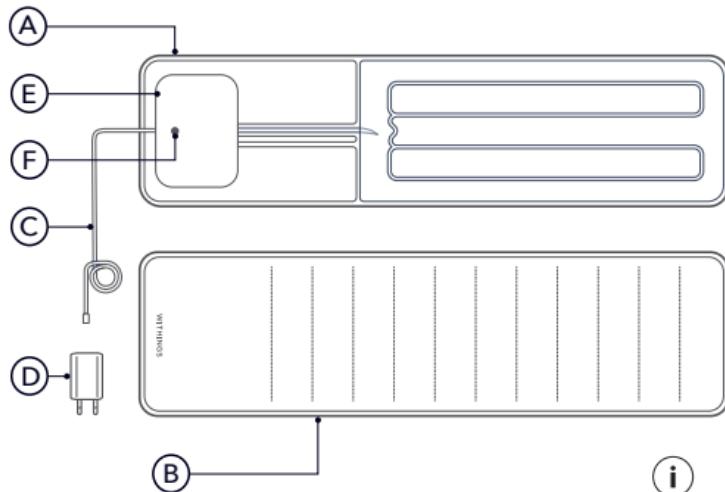

EN You can deactivate the sound sensor in your settings in the Health Mate app
FI Voit poistaa äänitunnistimen käytöstä Health Mate -sovelluksen asetuksista
SW Du kan avaktivera ljudsensorn i dina inställningar i Health Mate-appen
DA Du kan deaktivere lydsensoren i dine indstillinger i Health Mate-appen
NO Du kan deaktivere lydsensoren i innstillingene i Health Mate-appen

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important note: Radiation Exposure Statement

The product complies with the US portable radio frequency (RF) exposure limit set forth for an uncontrolled environment and is safe for intended operation as described in this manual. Further RF exposure reduction can be achieved if the product is kept as far as possible from the user's body or if the device is set to lower output power if this function is available.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Country Code selection feature to be disabled for products marketed to the US.

Liittovaltion viestintäkomission (FCC) häiriöilmoitus

12 - 13

Tämä laite on testattu, ja sen on todettu täyttävän FCC:n määräysten osassa 15 luokan B digitaalilaitteille asetetut rajat. Näiden rajoitusten tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suoja häiriöiltä asuinrakennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi sähköllä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi häirittää radioviestintää. Emme kuitenkaan voi taata, että häiriötä ei tapahdu tietynlaissa asennuksessa. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisioalojen vastaanottoa, mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriö jollakin seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Aseta laite kauemmas vastaanottimesta.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio/TV-teknikolta.

FCC:n varoitus: Muutokset tai korjaukset, joita vaativimustenmukaisuudesta vastaava taho ei ole erikseen hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Tämä laite on FCC:n määräysten kohdan 15 mukainen. Käyttö edellyttää seuraavien kahden ehdon täyttymistä: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriötä, ja (2) tämän laitteen on vastaanotettava kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa epätoivottua toimintaa.

Tärkeä huomautus: Säteilyaltistuslausunto

Tuote täyttää Yhdysvaltain viranomaisten kannettavien radioiden taajuudelle asettaman altistusrajan valvomattomassa ympäristössä ja on turvallinen tässä oppaassa kuvattun käyttötarkoitukseen. Radiotaajuudelle altistumista voidaan vähentää, jos tuotetta pidetään mahdollisimman kaukana käyttäjän kehosta tai jos laitteelle määritetään alempi lähtöteho, mikäli tämä toiminto on käytettävissä.

Lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää yhdessä muiden antennien tai lähettimien kanssa.

Maakoodin valintaominaisuus poistettavaksi käytöstä tuotteista, joita markkinoidaan Yhdysvalloissa.

Federal Communication Commission Interference Statement

Denna utrustning har testats och uppfyller gränsvärdena för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid en installation i bostäder. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka skadliga störningar av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte uppstår i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

FCC-varning: Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan gör det förbjudet att användaren använda denna utrustning.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Driften omfattas av följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Viktig upplysning: Strålningsexponeringsuttalande

Produkten överensstämmer med den amerikanska exponeringsgränsen för bärbar radiofrekvens (RF) som fastställts för en okontrollerad miljö och är säker för avsedd användning enligt beskrivningen i denna handbok. Ytterligare RF-exponeringsreduktion kan uppnås om produkten hålls så långt borta från användarens kropp som möjligt eller om enheten är inställt på att sänka utgångseffekten om denna funktion är tillgänglig.

Denna sändare får inte samlokaliseras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Funktionen för val av landskod ska inaktiveras för produkter som marknadsförs i USA.

Federal Communication Commission Interference Statement

14 - 15

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i et beboelsesbyggeri. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens til radio- eller tv-modtagelse, som kan bestemmes ved at lukke og slukke for udstyret, opfordres bruger til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Omdirigér eller flyt modtageren.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp.

FCC-advarsel Eventuelle ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af parten, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugernes autoritet til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Vigtig bemærkning: Erklæring for strålingsekspонering

Produktet overholder den amerikanske bærbare eksponeringsgrænse for radiofrekvens (RF), der er fastsat for et ukontrolleret miljø, og er sikkert for tilsiget drift som beskrevet i denne vejledning. Den yderligere reduktion af RF-eksponering kan opnås, hvis produktet kan holdes så langt væk som muligt fra brugerens krop eller indstilles til at sænke udgangseffekten, hvis en sådan funktion er tilgængelig.

Denne sender må ikke være placeret sammen med eller fungere sammen med andre antenner eller sendere.

Funktionen til valg af landekode skal deaktivieres for produkter, der markedsføres til USA.

Interferenserklæring fra Federal Communication Commission

Dette utstyret er testet og det ble funnet at det overholder grensene for digitale enheter av klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig grad av beskyttelse mot skadelig interferens ved installering i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake interferens som er skadelig for radiokommunikasjoner. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret skulle forårsake skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan fastsettes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen gjennom ett av de følgende tiltakene:

- Omorienter eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

FCC-advarsel: Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig godkjennes av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å bruke dette utstyret.

Denne enheten samsvarer med del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere enhver mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket funksjon av enheten.

Viktig merknad: Erklæring om strålingseksposering

Produktet samsvarer med USAs bærbare radiofrekvens (RF)-eksponeringsgrense fastsatt for et ukontrollert miljø og er trygt for tiltenkt bruk som beskrevet i denne håndboken. Videre reduksjon av RF-eksponering kan oppnås hvis produktet holdes så langt det er mulig fra brukerens kropp eller hvis enheten er satt til lavere utgangseffekt hvis denne funksjonen er tilgjengelig.

Denne senderen må ikke samlokaliseres eller brukes i kombinasjon med andre antenner eller sendere.

Funksjon for valg av landskode som skal deaktivieres for produkter som er markedsført i USA.

CAUTION

EN -Only the power supply that was included with the device should be used. Withings warranty does not cover defects due to the use of parts not provided by WITHINGS in the original packaging.

FI - Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua virtalähettää. Withings-takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat sellaisten osien käytöstä, joita WITHINGS ei ole toimittanut alkuperäisessä pakkauksessa.

SWE -Endast den strömadapter som medföljde enheten får användas. Withings garanti täcker inte defekter på grund av användning av delar som inte levereras av WITHINGS i originalförpackningen.

NO - Bruk kun strømforsyningen som fulgte med enheten. Withings-garantien omfatter ikke feil som skyldes bruk av deler som ikke er levert i originalemballasje fra WITHINGS.

DK -Anvend kun den strømforsyning, som følger med enheden. Withings' garanti dækker ikke defekter forårsaget af brug af dele, der ikke er leveret af WITHINGS i den originale emballage.

US Withings Two (2) Years Limited Warranty – Withings Sleep Analyzer

Withings 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, France ("Withings") warrants the Withings-branded hardware product ("Withings Product") against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Withings' published guidelines for a period of TWO (2) YEARS from the date of original retail purchase by the end-user purchaser ("Warranty Period"). Withings' published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or quick start guide. Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product's use.

FI Withingsin kahden (2) vuoden kaupallinen takuu – Withings Sleep Analyzer

Withings, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, Ranska («Withings») myöntää Withings-merkkiselle laitteistotuotteelle («Withings-tuote») Withingsin julkaisemien ohjeiden mukaisessa normaalikäytössä syntyneiden materiaali- ja valmistusvirheiden varalta KAHDEN (2) VUODEN takuun siitä päivästä lukien, jolloin loppukäyttäjä on alun perin ostanut sen vähittäismyyjältä («takuuaika»). Withingsin julkaisemat ohjeet käsittävät muun muassa teknisissä tiedoissa, turvaohjeissa sekä pika-asennusoppaassa olevat tiedot.

Withings ei takaa Withings-tuotteen keskeytyksetöntä tai virheettöntä toimintaa. Withings ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat Withings-tuotteen käytön liittyvien ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

SW Withings två (2) års kommersiell garanti – Withings Sleep Analyzer

Withings 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrike ("Withings") garanterar Withings-märkt hårdvaruprodukt ("Withings-produkt") mot defekter i material och tillverkning när den används normalt i enlighet med Withings publicerade riktlinjer under en period av TVÅ (2) ÅR från datumen för slutanvändarens ursprungliga inköp ("Garantiperiod"). Withings publicerade riktlinjer omfattar men är inte begränsat till information som finns i tekniska specifikationer, säkerhetsinstruktioner eller snabbsstartsguiden. Withings garanterar inte att driften av Withings-produkten kommer att vara avbrottsfri eller felfri. Withings ansvarar inte för skador som uppstår till följd av underlätenhet att följa instruktioner som rör Withings.

DA Withings' to (2) års kommersielle garanti – Withings Sleep Analyzer

Withings, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrig ("Withings") garanterer det Withings-mærkede hardwareprodukt ("Withings-produkt") mod defekter i materialer og udførelse, når det

anvendes normalt i overensstemmelse med Withings' offentliggjorte retningslinjer i en periode på TO (2) ÅR fra datoен for slutbrugerens oprindelige køb ("Garantiperiode"). Withings' offentliggjorte retningslinjer omfatter, men er ikke begrænset til oplysninger, der findes i tekniske specifikationer, sikkerhedsinstruktioner eller hurtig startvejledning. Withings garanterer ikke, at driften af Withings-produktet vil være uden afbrydelse eller fejlfri. Withings er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af instruktioner vedrørende Withings-produktets brug.

NO Withings to (2) års kommersiell garanti – Withings Sleep Analyzer

Withings 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrike («Withings») garanterer Withings-merket maskinvareprodukt («Withings-produkt») mot feil i materialer og utførelse når det brukes normalt i samsvar med Withings publiserte retningslinjer i en periode på TO (2) ÅR fra datoen for det opprinnelige detaljhandelkjøpet av sluttbrukeren («Garantiperiode»). Withings publiserte retningslinjer inkluderer, men er ikke begrenset til, informasjon nevnt i de tekniske spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksjonene eller hurtigstartsværingen. Withings garanterer ikke at bruken av Withings-produktet vil være uavbrutt eller feilfri. Withings er ikke ansvarlig for skade som følge av manglende overholdelse av instruksjoner knyttet til Withings-produktets bruk.

- EN** Withings hereby declares that the device Withings Sleep Analyzer is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be found at: Withings.com/compliance
- FI** Withings vakuuttaa täten, että Withings Sleep Analyzer -laite on olennaisten vaatimusten ja muiden asiakkuuluivien direktiivin 2014/53/EU vaatimusten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävillä osoitteessa withings.com/compliance
- SW** Withings försäkrar härmed att enheten Withings Sleep Analyzer uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta krav i EU-direktiv 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse finns på: Withings.com/afterlevnad
- DA** Withings erklærer hermed, at enheden Withings Sleep Analyzer er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæringen findes på: Withings.com/compliance
- NO** Withings erklærer herved at enheten Withings Sleep Analyzer samsvarer med de grunnleggende kravene og andre relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen finnes på: Withings.com/compliance

Mode	Frequency Band (MHz)	Maximum Output Power (dBm)
802.b/g/n	2400-2483.5	
BT-LE	2402-2480	8.09
BT EDR	2402-2480	0.61





Need help?

Tarvitsetko apua? | Behöver du hjälp? | Brug for hjælp? | Trenger du hjelp?

→ withings.com/support/sleep

WITHINGS

Withings Sleep Analyzer - Model: WSM02 - V2.0

© 2021 Withings All rights reserved.